


ალბორითში
ახალშობილის სხეულის ტემპერატურის მონიტორინგი

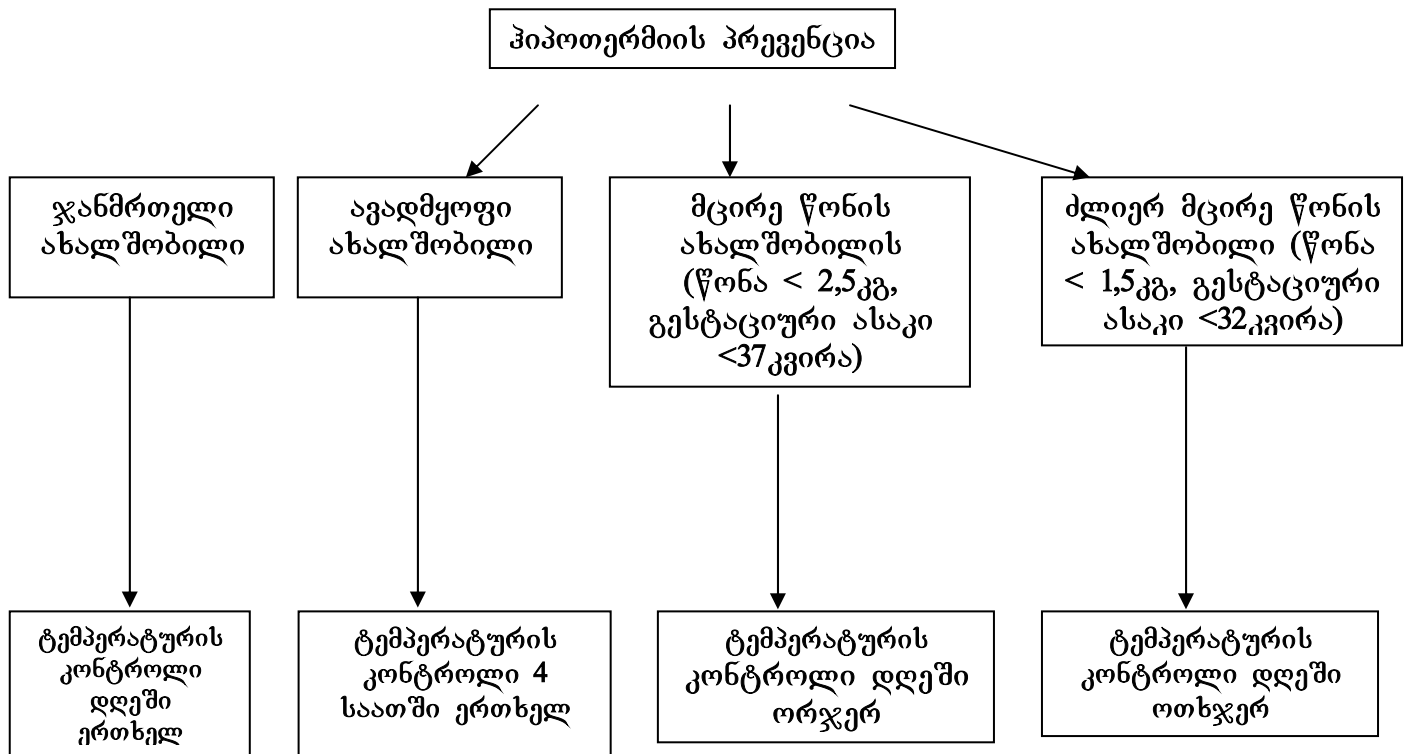

ჰიპოთერმიული ახალშობილის ტემპერატურის კონტროლი

- ინკუბატორში მოთავსებიდან 30 წთ-ში;
- ტემპერატურის სტაბილიზაციამდე საათში ერთხელ
- შემდეგ 4 საათში ერთხელ.